


Roche Elecsys® sFlt-1/PIGF

Spezifität und Sensitivität der Präeklampsie

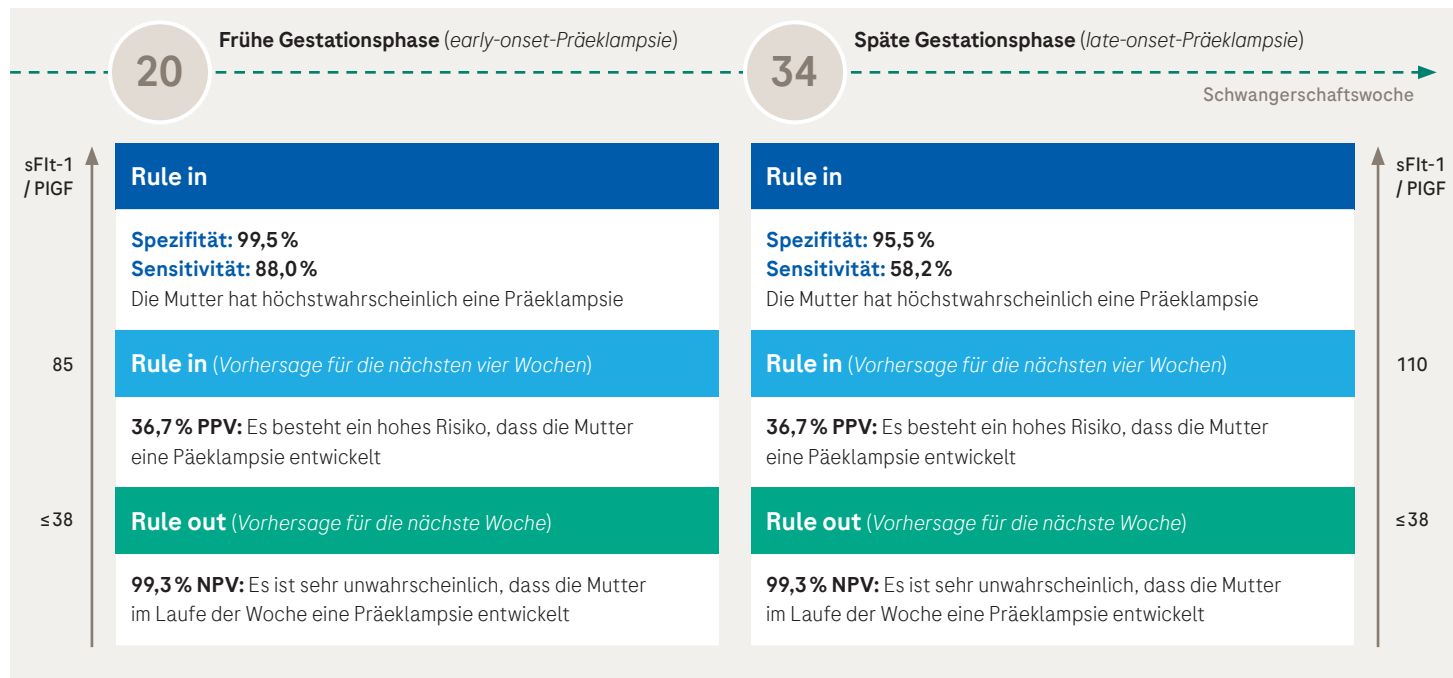

Roche Elecsys® sFlt-1/PlGF

Biomarker zur Diagnose und Vorhersage der Präeklampsie¹

Feststellung des sFlt-1/PlGF Faktors ab Schwangerschaftswoche 20+0

Patientenprofil:²⁻⁵

01



Klinischer Verdacht auf
Präeklampsie

oder

02



Pathologischer Doppler –
Ultraschall der uterinen Arterie

oder

03



**Vorliegen eines der folgenden
Risikofaktoren:**

- Präeklampsie in einer vorherigen Schwangerschaft
- Chronischer Bluthochdruck
- Vorbestehende Nierenerkrankung
- Diabetes mellitus
- Als Hochrisiko im Präeklampsie-Screening des 1. Trimester identifiziert

Probenmaterial: Serum

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und ELECSYS sind Marken
von Roche.
© 2025 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

1. Elecsys® PlGF and Elecsys® s-Flt1 package inserts, 2018.
2. Rolnik et al. (2017). N Engl J Med. 377(7), 613-622 (ASPREE).
3. O'Gorman, N. et al. (2016). Am J Obstet Gynecol. 214(1), 103.e1-103.e12.
4. Tsiakkas, A. et al. (2016). Ultrasound Obstet Gynecol 47, 472-477.
5. O'Gorman, N. et al. (2017). Ultrasound Obstet Gynecol 49, 756-760.